


測定子(取付ネジM2.5、市販の測定子と交換可能)

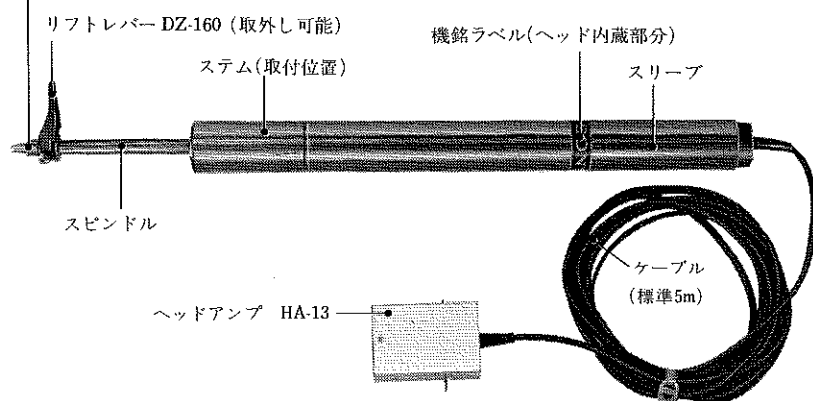

●規格および仕様

	DG-50	DG-50S
測定範囲	0~50mm	
ゲージ精度	±0.001mm	
測定圧	下方位	125±25g
	横方位	85±25g
	上方位	40±25g
測定子	超硬合金球面付 DZ-122	
ステム径	φ20 ⁺⁰ _{-0.03} mm	
外形寸法	φ20×292mm	
重量	0.75kg	
ケーブル長	5m (標準)、特注により 10m まで	
防塵シール	無	オイルシールリング付

●ご使用にあたって

- 測長ユニットの取付けは必ずステムをチャックしてください。他の部分を保持しなければならない場合は、機銘ラベル部を避けてください。押しネジが直接当たらないようにします。
- 取付平行度はゲージ精度に影響しますから、取付ブラケット(またはスリーブ)で100mmの移動に対し、0.3mm以内に調整します。
- 切粉や切削油、機械油等がかかる場合は適切なカバーを設けてください。完全防水型ではありません。
DG-50型は、防塵シール無しのタイプですから、環境良好な測定室向きです。

- ヘッドアンプは測長ユニットを取付け後、表示ユニットまたはデテクタに挿入し、ネジでしっかり固定します。
着脱時には必ず電源を切ってください。
- ケーブルは断線を防ぐために適当な場所へ固定するようにしてください。
- プローブ本体は、ケーブルのシールド線により、表示ユニットのアース端子と電気的に短絡されています。
工作機械等へ取付けてデテクタおよび他の信号処理装置と組合せる場合は、アースレベルにご注意ください。

●デジタルゲージスタンド DZ-500

●デジタルゲージホルダー DZ-400

●デジタルゲージスタンド：DZ-500


デジタルゲージの機能を十二分に発揮できるように設計してあります。

測定テーブル：106×106mm 支柱：φ40×367mm
測高：200mm 奥行：80mm

●デジタルゲージホルダー：DZ-400

底面より、水平、垂直、任意の位置に測長ユニットを固定させます。
支柱：φ25×200mm 腕：φ14×150mm

〔デジタルゲージホルダー DZ-400の使用例〕

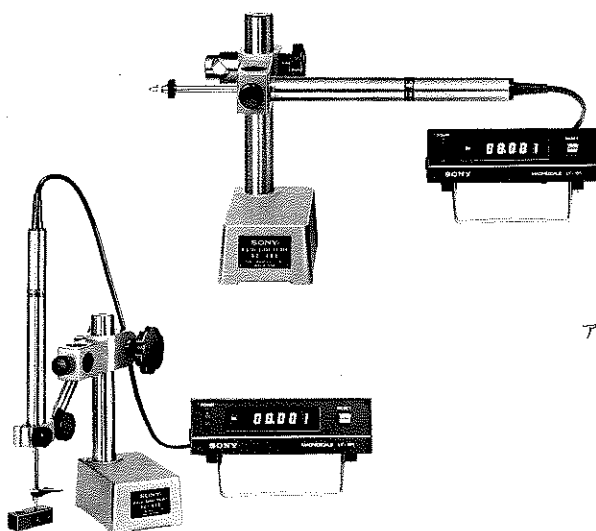

〔デジタルゲージスタンド DZ-500の使用法〕


●絶対測定

測長ユニット(DG-50等)のステム部分を保持するようにしてスタンドに取付けます。スタンドのアームの高さを調節して固定します。テーブルに測定子を当て、その状態でデジタル表示装置のリセットボタン[RESET]を押してリセットします。測定ストロークが大きいので絶対測定ができます。

●比較測定


任意のブロックゲージを選んでテーブル上に置き、ブロックゲージに測定子を当てて、リセットします。デジタル表示装置は任意の位置でリセットできますから、容易に比較測定ができます。

- 注意事項 1. 測長ユニットの取付けは、ステムをつかむようにしてください。もし、スリーブをつかむ必要が生じたときは、銘板付近だけは避けてください。
- 2. デジタルゲージの測定子は超硬合金チップ付ですので、DZ-500の測定テーブルにスピンドルを大きく引いた位置から急激に放しますと、テーブル面をいためますので注意してください。

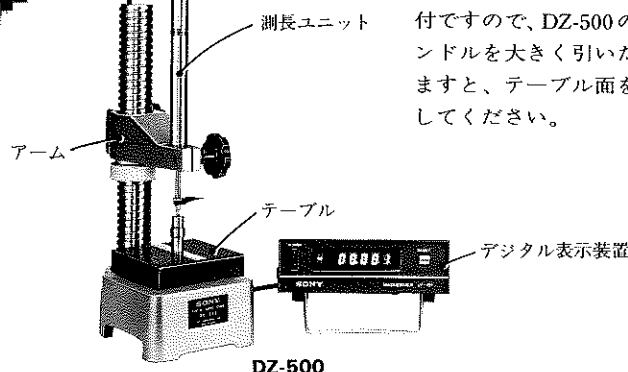


DZ-500

DG-50, 50S



- ゲージスタンド DZ-500
- ゲージホルダー DZ-400
- 収納用木箱 DW-50



本 社 営 業 部	〒141 東京都品川区西五反田3丁目9番17号	東洋ビル	電話 03(490)3920
大 阪 営 業 所	〒532 大阪市淀川区西中島5丁目11番10号	第三中島ビル	電話 06(305)3101
名古屋営業所	〒464 名古屋市千種区内山3丁目10番17号	今池セントラルビル	電話052(741)1381-4
福岡営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東2丁目5番19号	サンライフ第3ビル	電話092(473)1357
サービスセンター	〒141 東京都品川区西五反田3丁目9番17号	東洋ビル	電話 03(490)3921

A detailed line drawing of the Sony CCD camera assembly. The assembly consists of a camera unit mounted on a base. The camera unit is connected to a mounting bracket, which is secured to the base. A cable is shown extending from the camera unit. The base is labeled 'SONY'.

本 社 営 業 部	〒141 東京都品川区西五反田3丁目9番17号	東洋ビル	電話 03(490)3920
大 阪 営 業 所	〒532 大阪市淀川区西中島5丁目11番10号	第三中島ビル	電話 06(305)3101
名古屋営業所	〒464 名古屋市千種区中島3丁目10番17号	今池セントラルビル	電話052(741)1381-4
福岡営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東2丁目5番19号	サンライフ第3ビル	電話092(473)1357
サービスセンター	〒141 東京都品川区西五反田3丁目9番17号	東洋ビル	電話 03(490)3921

1984.07 Y100